



## Kalibrierschein / Calibration Certificate



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-15070-01-00

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium  
issued by the calibration laboratory

Testo Industrial Services GmbH  
Erich-Rieder-Straße 4  
79199 Kirchzarten

Kalibrierzeichen  
Calibration mark

MUSTER
D-K- 15070-01-00
2025-02

Gegenstand  
*Object* Bügelmessschraube

Hersteller  
*Manufacturer* ORION

Typ  
*Type* ---  
0 - 25 mm

Fabrikat/Serien Nr.  
*Serial number* 123455656

Equipment Nr.  
*Equipment number* 12345678

Prüfmittel Nr.  
*Test equipment no.* P654

Auftraggeber  
*Customer* Musterzertifikat GmbH  
DE-12345 Musterhausen

Auftragsnummer  
*Order No.* 654321 / 0520 4480

Datum der Kalibrierung  
*Date of calibration* 04.02.2025

Datum der Rekalibrierung  
*Date of re-calibration* 28.02.2026

Konformitätsaussage  
*Statement of conformity* Pass

Weitere Informationen auf Seite 4  
*Further information see page 4*

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf das Internationale Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner des multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die Messergebnisse beziehen sich nur auf den kalibrierten Gegenstand. Das Laboratorium gibt keine Empfehlung über das Kalibrierintervall. Für die Festlegung und Einhaltung von Fristen zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*This calibration certificate documents the metrological traceability to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The measurement results refer only to the calibration object. The laboratory does not make any recommendation about the calibration interval. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.*

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.*

Datum  
*Date* 04.02.2025  
Leiter des Kalibrierlaboratoriums  
*Head of the calibration laboratory*  
  
Max Mustermann

Freigabe des Kalibrierscheins durch  
*Approval of the certificate of calibration by*  
  
Martina Musterfrau

## Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 04.02.2025

**Kalibriergegenstand** Calibration object

Gegenstand Object	Bügelmessschraube
Messbereich Measuring range	0 - 25 mm
Ziffersschritt Number step	0,010 mm
Anzeigetyp Indicator type	Strich- und Rundskala Division, round scale
Norm Standard	DIN 863-1:1999 (nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001) unter Berücksichtigung mit DIN EN ISO 3611:2024-09
Inventar Nr. Inventory no.	5886
Standort Location	---

**Kalibrierverfahren** Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001-11 Prüfanweisung für Bügelmessschrauben  
The calibration was carried out according to VDI/VDE/DGQ 2618 sheet 10.1:2001-11 Test instructions for outside micrometers

**Umgebungsbedingungen** Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgeführt.  
All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

Temperatur Temperature (18...22) °C Feuchte Humidity (20...60) % rF % RH

**Messeinrichtungen** Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. Eq.-no.
Parallel-Endmaßsatz gage block set	D-K-15190-01-00 2022-09	2025-09	L225636	10113375
Planglas-Set plan glass set	D-K-15077-01-00 2020-02	2025-02	3467103	12042890

Referenzzertifikate sind auf [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com) abrufbar Reference certificates are available at [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com)

**Vorbereitende Prüfungen und Tätigkeiten** Preparing examinations and activities

Sichtprüfung Visual inspection	In Ordnung In order Leichte Kratzer auf den Messflächen. Slight scratches on the measurement surface.
Funktionsprüfung Functional check	In Ordnung In order Ratschenmesskraft liegt zw. 5 - 10 N. Ratch measuring force is between 5 - 10 N.



**Messergebnisse** Measuring results


	Ermittelte max. Messabweichung Determined max. measurement deviation $\mu\text{m}$	Zulässige Abweichung Allowed deviation $\mu\text{m}$	Messunsicherheit ( $k=2$ ) Measuring uncertainty ( $k=2$ ) $\mu\text{m}$	Bewertung Confirmation
Parallelitätsabweichung der Messflächen Deviation of parallelism of the measuring surfaces	1,20	2,00	n.a.*	pass
Ebenheitsabweichung der Messflächen Flatness deviation of the measuring surfaces	0,60	0,64	n.a.*	pass
Messabweichung $y_i$ / Fehlergrenze $G$ Deviation $y_i$ / Error margin $G$	1,0	4,0	3,2	pass

\*Für diese Parameter ist die akkreditierte Messunsicherheit nicht anwendbar.

\*For these parameters the accredited uncertainty of measurement is not applicable.

	Bezugswert Reference value mm	Messwert Kalibriergegenstand Measuring value calibration object mm	Abweichung Deviation $\mu\text{m}$
Messabweichung $y_i$ Deviation $y_i$	0,000	0,000	0,0
	5,100	5,101	1,0
	10,300	10,300	0,0
	15,000	15,001	1,0
	20,200	20,201	1,0
	25,000	25,000	0,0

**Grafische Darstellung der Messergebnisse** Chart of the measuring results

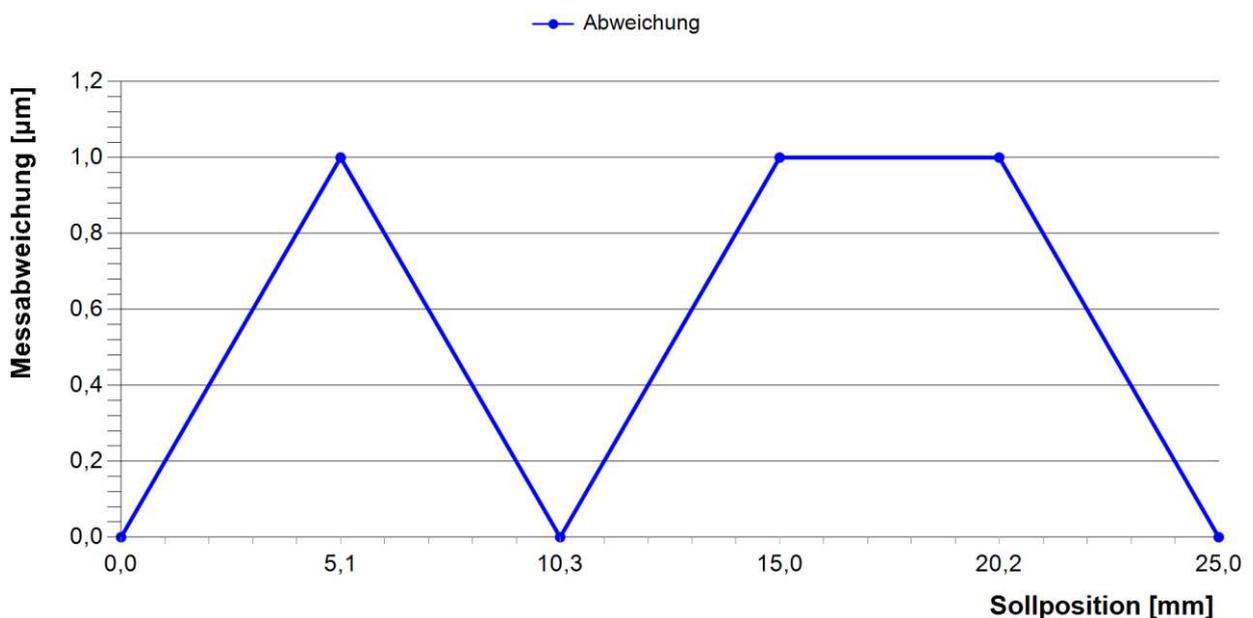

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 04.02.2025

**Messunsicherheit** Measurement uncertainty

$U = 3,0 \mu\text{m} + 10,0 \cdot 10^{-6} \cdot l$  ( $l$  entspricht der gemessenen Länge) ( $l$  corresponds to the measured length)

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k = 2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95% im zugeordneten Werteintervall.

The extended measurement uncertainty which is resulting from the standard measurement uncertainty by multiplying with the coverage factor  $k = 2$  is indicated. It was determined according to EA-4/02 M: 2022. The value of the measured value is in the assigned value interval with a probability of approximately 95%.

**Bemerkungen** Remarks

---  
---

**Konformitätsaussage** Conformity

Alle Messergebnisse liegen innerhalb der zulässigen Abweichung.  
All measurement results are within the allowed deviation.

Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50" mit einer Konformitätswahrscheinlichkeit größer 50%  
The conformity statement is made in accordance with the decision rule "Confidence level 50" with a conformity probability greater than 50%.

Zulässige Abweichung gemäß Norm.  
Allowed deviation determined by the associated norm.

Die Einhaltung der zulässigen Abweichung wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:  
The compliance to allowed deviation is represented on the calibration certificate as follows:

Messwert und Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value and measurement uncertainty inside the allowed deviation.	pass	
Messwert innerhalb und Messunsicherheit teilweise außerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value inside and measurement uncertainty partly outside the allowed deviation.	pass	
Messwert außerhalb und Messunsicherheit teilweise innerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value outside and measurement uncertainty partly inside the allowed deviation.	fail	
Messwert und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value and measurement uncertainty outside the allowed deviation.	fail	

The German original text is valid in case of doubt.

- Ende des Kalibrierscheins -  
- End of the calibration certificate -

