



## Kalibrierschein / Calibration Certificate

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium  
issued by the calibration laboratory



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-15070-01-01

MUSTER
D-K- 15070-01-01
2020-04

Testo Industrial Services GmbH  
Gewerbestraße 3  
79199 Kirchzarten

Kalibrierzeichen  
Calibration mark

Gegenstand  
Object

Gewinde-  
Grenzlehrdorn

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Hersteller  
Manufacturer

---

Typ  
Type

---

M 4x0.7-6E

Fabrikat/Serien Nr.  
Serial number

B017

Equipment Nr.  
Equipment number

---

Prüfmittel Nr.  
Test equipment no.

---

Auftraggeber  
Customer

Musterfirma GmbH  
DE-12345 Musterstadt

Auftragsnummer  
Order No.

123456 / 0520 4720

Datum der Kalibrierung  
Date of calibration

07.04.2020

Datum der Rekalibrierung  
Date of re-calibration

07.10.2020

Konformitätsaussage  
Statement of conformity

Messwert(e) innerhalb der zulässigen Abweichung  
Measured value(s) within the allowed deviation

Detaillierte Informationen auf Seite 4  
Detailed information see page 4

Messwert(e) ausserhalb der zulässigen Abweichung  
Measured value(s) outside the allowed deviation

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Datum  
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums  
Head of the calibration laboratory

Freigabe des Kalibrierscheins durch  
Approval of the certificate of calibration by

07.04.2020

Max Mustermann

Martina Musterfrau

MUSTER
D-K- 15070-01-01
2020-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 07.04.2020

### Kalibriergegenstand Characteristics to the calibration article

Gegenstand Object	Gewinde-Grenzlehrdorn	
Nennmaß Nominal size	M 4x0.7-6E	
Norm Standard	Metrische ISO Gewinde nach DIN ISO 965:1999 / DIN ISO 1502:1996 (DIN 13)	
Ø-Draht Wire diameter	0,3900 mm	
Steigung Pitch	0,7000 mm	
1./2. Teilflankenwinkel 1./2. screw thread angle	30,00° / 30,00°	
Gutseite Go side	Maximum Maximum	3,6115 mm
	Minimum Minimum	3,6025 mm
	Abgenutzt Outworn	3,5945 mm
Ausschusseite Scrap side	Maximum Maximum	3,7280 mm
	Minimum Minimum	3,7190 mm
	Abgenutzt Outworn	3,7140 mm
Inventar Nr. Inventory no.	---	
Standort Location	GEWINDESCHNEIDEN	

### Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte auf Grundlage der Richtlinie EURAMET cg-10, Version 2.1:2012-12 und der DKD-R 4-3 Blatt 4.8:2018-09, Kalibrierung von zylindrischen Gewinde-Einsteldornen, Gewinde-Lehrdornen und -Prüfdornen – Punkt 5.3.1, Option 1: Ermittlung des einfachen Flankendurchmessers. (Hinweis: Normativ geforderte Kalibrierungen des Gewindeprofilwinkels und der Steigung aus früheren Kalibrierungen liegen in der Verantwortung des Kunden.) Punkt 5.3.1, Option 1: Ermittlung des einfachen Flankendurchmessers. (Hinweis: Normativ geforderte Kalibrierungen des Gewindeprofilwinkels und der Steigung aus früheren Kalibrierungen liegen in der Verantwortung des Kunden.)

The calibration is performed on the basis of the EURAMET cg-10, Version 2.1:2012-12 and the DKD-R 4-3 Sheet 4.8:2018-09, calibration of cylindrical setting adjustment, screw ring gauge – point 5.3.1, Option 1: Definition of the simple pitch diameter. (Note: Normative required calibrations of the thread profile angle and the slope from previous calibrations are the responsibility of the customer.) point 5.3.1, Option 1: Definition of the simple pitch diameter. (Note: Normative required calibrations of the thread profile angle and the slope from previous calibrations are the responsibility of the customer.)

### Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgeführt.  
All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

Temperatur Temperature (19...21) °C Feuchte Humidity (20...60) % rF % RH

### Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. Eq.-no.
Längenmessmaschine length measuring machine	ISO 2019-10	2020-04	3342038	10113369
Parallel-Endmaß gage block	15190-01-00 2020-01	2021-01	3433884	12482215

Referenzzertifikate sind auf [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com) abrufbar Reference certificates are available at [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com)



MUSTER
D-K- 15070-01-01
2020-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 07.04.2020

### Vorbereitende Prüfungen und Tätigkeiten Preparing examinations and activities

Sichtprüfung  
Visual inspection

In Ordnung  
In order



---

Funktionsprüfung  
Functional check

In Ordnung  
In order

---

### Messergebnisse Measuring results

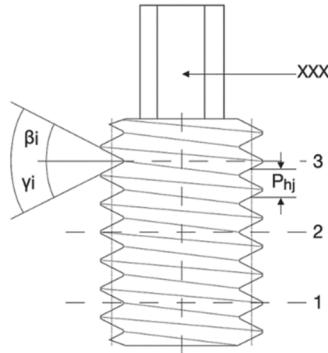

Gutseite Go site

Profilschnitt Profile section	Meseebene Measuring surface	Prüfmaß Standard of verification mm	Flankendurch- messer Simple pitch diameter mm	Toleranz-Einhaltung Tolerance observance	Messunsicherheit Measuring uncertainty µm	Bewertung Confirmation
1 (0°)	1	4,1706	3,6069	-----x-----	3,0	pass
1 (0°)	2	4,1711	3,6074	-----x-----	3,0	pass
1 (0°)	3	4,1719	3,6082	-----x-----	3,0	pass
2 (90°)	1	4,1709	3,6072	-----x-----	3,0	pass
2 (90°)	2	4,1720	3,6083	-----x-----	3,0	pass
2 (90°)	3	4,1724	3,6087	-----x-----	3,0	pass
Mittelwert Average		4,17148	3,60778			

Ausschusseite Ausschusseite

Profilschnitt Profile section	Meseebene Measuring surface	Prüfmaß Standard of verification mm	Flankendurch- messer Simple pitch diameter mm	Toleranz-Einhaltung Tolerance observance	Messunsicherheit Measuring uncertainty µm	Bewertung Confirmation
1 (0°)	1	4,2867	3,7231	-----x-----	3,0	pass
1 (0°)	2	4,2906	3,7270	-----x-----	3,0	pass
2 (90°)	1	4,2912	3,7276	-----x-----	3,0	pass
2 (90°)	2	4,2908	3,7272	-----x-----	3,0	pass
Mittelwert Average		4,28983	3,72623			



MUSTER
D-K- 15070-01-01
2020-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 07.04.2020

### **Messunsicherheit** Measurement uncertainty

$$U = 3,0 \mu\text{m} + 10,0 \cdot 10^{-6} \cdot d \quad (d \text{ entspricht dem gemessenen Durchmesser}) \quad (d \text{ corresponds to the measured diameter})$$

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k = 2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2013 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Wertebereich.

The extended measurement uncertainty which is resulting from the standard measurement uncertainty by multiplying with the coverage factor  $k = 2$  is indicated. It was determined according to EA-4/02 M: 2013. The value of the measured value is in the assigned value interval with a probability of 95%.

### **Bemerkungen** Remarks

---

### **Konformitätsaussage** Conformity statement

Innerhalb der zulässigen Abweichung <sup>1)</sup>

Inside the allowed deviation <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Die Konformitätsaussage erfolgt in Anlehnung an ISO 14253-1:2017 auf Basis der Entscheidungsregel "niedriges Vertrauensniveau" gemäß 4\_AA\_00120\_DE.

<sup>1)</sup> The statement of conformity is based on ISO 14253-1:2017 in accordance with the decision rule "niedriges Vertrauensniveau" (low level of confidence) according to 4\_AA\_00120\_DE.

Zulässige Abweichung gemäß Norm.

Allowed deviation determined by the associated norm.

The German original text is valid in case of doubt.

